

Специалисты «Центра экспертиз» посетили выставку оборудования «Экспо Контроль 2021»

09.09.2021


XII Тематическая выставка - форум метрологического и испытательного оборудования и приборов «Экспо Контроль 2021» на площадке центрального выставочного комплекса «Экспоцентр».



Целью мероприятия является создание площадки для взаимодействия потребителей и производителей измерительного, испытательного, лабораторного и метрологического оборудования.

На форуме представлены передовые научные разработки и технологии от лидеров производства более чем из 100 стран мира, представленных на российском рынке.



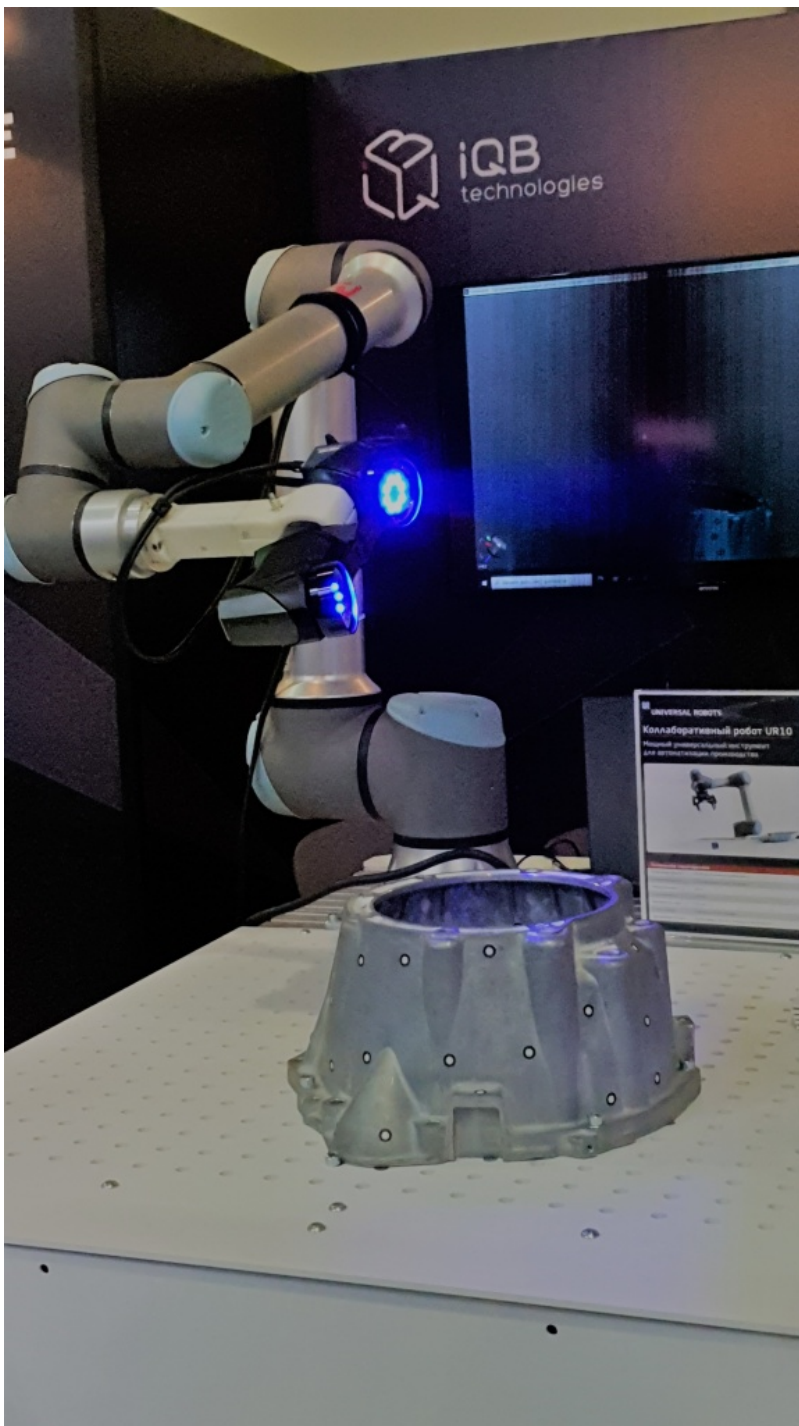

В рамках работы выставки предусмотрены не только экспозиции с демонстрацией оборудования, но и несколько семинаров специалистов отрасли.

На лекции представителя ФГУП «ВНИИМ им. Менделеева» на тему «Аттестация испытательного оборудования. Особенности требований документов по стандартизации» были подробно рассмотрены вопросы применения ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования» при проведении аттестации, разработке методики и программы аттестации. В частности, рассказано о требованиях к поверке средств измерений (СИ), входящих в состав испытательного оборудования, подвергаемого аттестации.

Испытательное оборудование можно поделить на несколько сфер применений и от этих сфер будут варьироваться требования, предъявляемые к СИ.

Средства измерения, предназначенные для оценки соответствия продукции обязательным требованиям должны иметь утвержденный тип (сведения об утвержденном типе включаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений) и поверены.

СИ, предназначенные для измерений параметров, воспроизводимых испытательным оборудованием условий испытаний (режимов функционирования продукции и/или воздействующих факторов) – безусловного требования об утверждении типа и поверке не имеют.

СИ, предназначенные для измерений служебных параметров испытательного оборудования, не относящихся к условиям испытаний продукции\материалов, а используемых персоналом для поддержания оборудования в работоспособном состоянии – калибруются. Либо переводятся в индикаторы.

Адрес страницы: <http://ceiis.mos.ru/presscenter/news/detail/10240722.html>

[ГБУ города Москвы «ЦЭИИС»](#)